



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/391/2011

Sanok, dnia 25 lipca 2011r.


do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/52/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych- staplery dla potrzeb SPZOZ w Sanoku.

* Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w części 1 pod pojęciem „jednorazowy stapler okrężny, zagięty, zszywki tytanowe” ma na myśli staplery długości standardowej i laparoskopowej o średnicy 21, 25, 28, 31, 33 (Zamawiający będzie mógł określić długość staplera przy składaniu zamówienia), które posiadają oryginalnie sztywne kowadełko, które po oddaniu strzału, łamie się do pozycji prawie pionowej i umożliwia dzięki temu bezpieczne wyjęcie staplera przez miejsce nowego zespolenia.

Poniżej zamieszczamy rysunek techniczny wskazujący zasadę działania „łamanej główki” i prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy takie rozwiązanie miał na myśli.

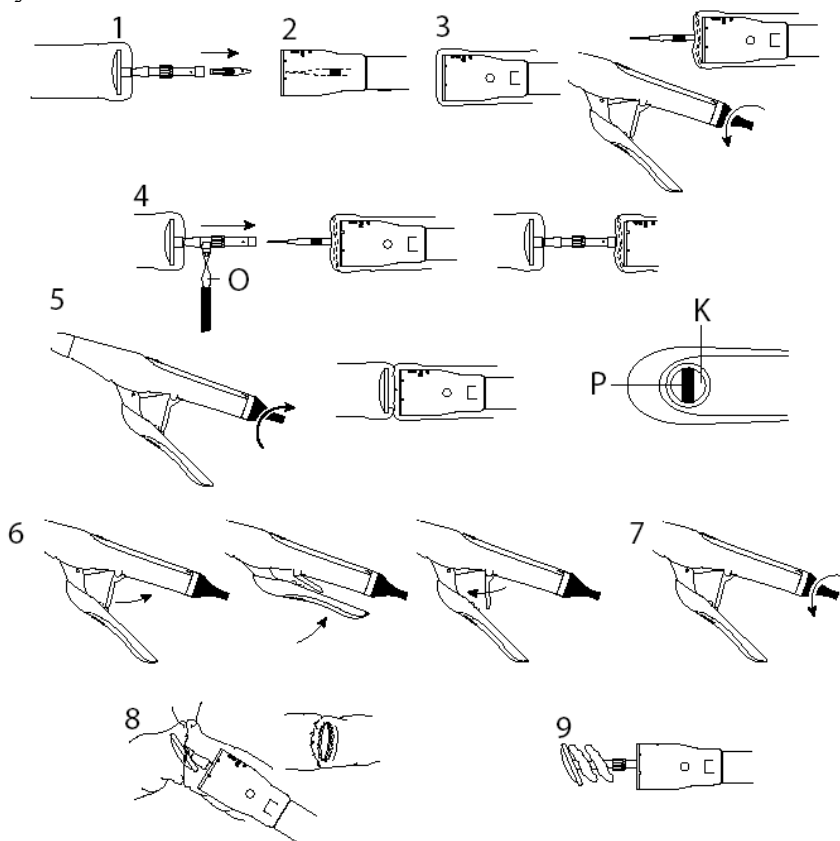

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie zszywki w staplerach były wykonane z tytanu – materiału biokompatybilnego oraz do oferty została dołączona karta charakterystyki poświadczająca skład metalu, z jakiego wykonane są zszywki? Tylko wówczas Zamawiający będzie mieć pewność, że oferowane staplery posiadają zszywki wykonane z tytanu, a pacjenci z wszczepionymi zszywkami będą mogli zostać poddani badaniu rezonansem magnetycznym. Zszywki niewiadomego pochodzenia wykonane ze stali chirurgicznej narażają pacjenta poddającego się badaniu rezonansem magnetycznym na bardzo poważne powikłania.

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga aby zszywki były wykonane z tytanu, natomiast nie wymaga lecz dopuszcza dołączenia kart charakterystyki poświadczających skład metalu, z jakiego wykonane są zszywki.*

*** Pytanie nr 3**

Z uwagi na coraz częstsze zastrzeżenia, co do jakości staplerów niektórych producentów, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie wymogu dostarczenia wraz z ofertą przynajmniej 5 międzynarodowych lub krajowych badań klinicznych, ewentualnie artykułów z uznanego piśmiennictwa medycznego, potwierdzających skuteczność oferowanego sprzętu. Pragniemy przypomnieć, że staplery chirurgiczne to trwale implanty, które pozostają w ciele pacjenta do końca życia i jakość oraz bezpieczeństwo zastosowanych materiałów mają priorytetowe znaczenie. Zamawiający będzie miał wówczas pewność, że oferowane produkty spełniają wysokie wymagania stawiane sprzętowi medycznemu z III grupy ryzyka (najwyższe ryzyko dla sprzętu na trwale pozostającego w ciele pacjenta).

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.*

*** Pytanie nr 4 - Dotyczy części 2**

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo linii szwu i prawidłowe zamknięcie zszywki wymaga, aby zszywki były bilateralnie spłaszczone na całej długości?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 5 - Dotyczy części 2**

Czy Zamawiający w trosce o łatwość użycia instrumentu w ograniczonej przestrzeni operacyjnej, wymaga, aby staplery posiadały możliwość zdalnego zamknięcia pinu, utrzymującego tkankę pomiędzy szczenkami instrumentu?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 6 - Dotyczy części 3** Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem do tkanki standardowej i grubej o długości linii szwu 60, 80 i 100mm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 7 - Dotyczy części 3**

Czy Zamawiający w trosce o minimalizację traumatyzacji tkanki podczas cięcia, a także minimalizacji ryzyka kroskontaminacji wymaga, aby staplery liniowe z nożem posiadały zintegrowany z ładunkiem nóż a zszywka była bilateralnie spłaszczona na całej długości?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 8 - Dotyczy części 3**

Czy Zamawiający w trosce o łatwość użycia instrumentu, wymaga, aby staplery liniowe z nożem miały obustronny suwak, służący do odpalenia instrumentu?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 9 -** Dotyczy części 3

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i ochronę, przed skaleczeniem ostrym nożem staplera, wymaga, aby po użyciu instrumentu, nóż był automatycznie zabezpieczany osłoną?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.*

*** Pytanie nr 10**

Prosimy o zwolnienie firmy z obowiązku dostarczenia próbek do postępowania.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

*** Pytanie nr 11 – dot. zał. nr 2, część 1(staplery okrężne), poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowane staplera w rozmiarze 24 lub 26?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

*** Pytanie nr 12 – dot. zał. nr 2, część 1 (staplery okrężne), poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplera w rozmiarze 29?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

*** Pytanie nr 13 – dot. zał. nr 2, część 1 (staplery okrężne), poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplera w rozmiarze 32?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

*** Pytanie nr 14 – dot. zał. nr 2, część 1 (staplery okrężne), poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplera w rozmiarze 34?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

*** Pytanie nr 15 – dot. treści SIWZ**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uściślenie czy przedmiot zamówienia opisany w załączniku nr 2 należy traktować jako jeden pakiet na co wskazywałoby wadium wymagane przez Zamawiającego. Jednocześnie prosimy o uściślenie czy zapis w pkt V SIWZ „Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części i składania ofert częściowych ” należy rozumieć tak, że oferty spełniające zapisy SIWZ to oferty złożone na cały asortyment wymieniony w zał. nr 2?

Odpowiedź: *Zamawiający wyjaśnia iż opisany przedmiot zamówienia należy traktować jako jeden pakiet.*

*** Pytanie nr 16 – dot. zał. nr 2, pkt. 2 i 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uściślenie czy w pkt. 2 i 3 Zamawiający przez „Rozmiar” rozumie długość szwu podaną w milimetrach (odpowiednio 45,60,90,55,75,100)?

Odpowiedź: *Zamawiający wyjaśnia iż przez „Rozmiar” rozumie długość szwu podaną w milimetrach.*

*** Pytanie nr 17 – dot. pakietu 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie staplerów jednorazowych okrężnych w rozmiarach do dowolnego wyru: 24mm, 26mm, 32mm, oraz 34mm o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 18 – dot. pakietu nr 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie staplerów jednorazowych w pozycji 1 oraz 2 o długości 60mm (wymagane 55mm) oraz w pozycji 3,4: 80mm (wymagane 75mm) o pozostałych parametrach technicznych zgodnych z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

UWAGA:

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Zważywszy na powyższe, jednocześnie mając na względzie umożliwienie potencjalnym wykonawcom złożenie ofert, zgodnie z art. 38 ust.6 prawa zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach.

Termin i sposób wniesienia wadium w pieniądzu - zmienia się termin na:

płatne do dnia 28.07.2011r. o godzinie 10.00

Termin i sposób wniesienia wadium w innej formie - zmienia się na termin na :

płatne do dnia 28.07.2011r. o godzinie 10.00

Nowy termin składania ofert upływa 28.07.2011r. o godz. 10⁰⁰

Nowy termin otwarcia ofert 28.07.2011r o godz. 11⁰⁰

Z poważaniem